

歯科切削加工用レジン材料

CeraFine[®] S

[保険適用]^{*1}

CeraFine[®] H

[保険適用]^{*2}



- ※1. CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の小白歯にご使用いただけます。
- ※2. CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の大白歯にご使用いただけます。

カラーバリエーション

シェード	A2	A3	A3.5
CeraFine S・H 単色			


※当パンフレットに掲載の製品画面・画像等は印刷物につき、実際の色調とは異なります。

※ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。


※保険適用は、ハイブリッドセラミックでかつ、小白歯で使用する場合に限ります。

研磨性


ナノサイズフィラーを細密充填することにより、平滑な研磨面を形成でき研磨性に優れます。




製品特長

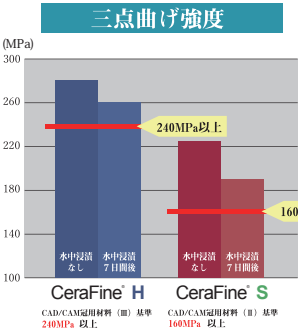


3点曲げ試験
CAD/CAM冠用材料の基準値・タイプ(H)では160MPa。37℃水中浸漬7日間後の3点曲げ強さが CeraFine S は基準値を満たしていることがわかります。

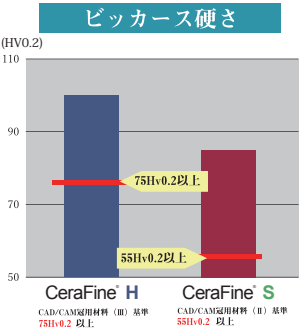

ビッカース硬さ試験
CAD/CAM冠材料の基準値を満たしておりま

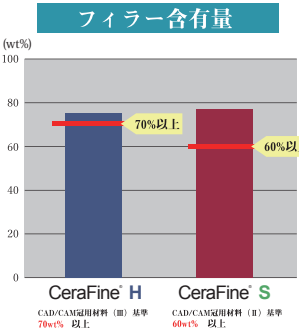


フィラー含有量
シラン処理剤をフィラー全面に均一にコーティングすることで CeraFine S がフィラー充填率を高めました。

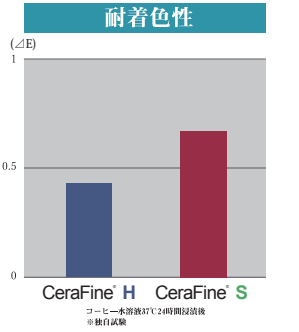

耐着色性
高圧成形の下で高度に加熱重合しているため、耐着色性に優れています。

データ提供：株式会社 カム・ネット

寸法および物性

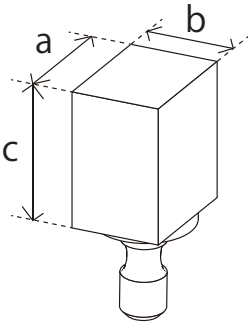

寸法

サイズ	種類	寸法 (mm)
S	a	10
	b	12
	c	15
M	a	14.5
	b	14.5
	c	18
14M	a	12
	b	14
	c	18

物性

項目		CeraFine S	CeraFine H
曲げ強度 (MPa)	3点曲げ (乾式)	230	280
	3点曲げ (水中浸漬7日間)	190	260
ビッカース硬さ (HV0.2)		85	100
蛍光性		あり	あり
造影性		あり	あり

商品コード	商品名	サイズ	包装
BCDM17900	セラファインS S A2	S	5個入
BCDM17901	セラファインS S A3		
BCDM17902	セラファインS S A3.5		
BCDM17903	セラファインS M A2		
BCDM17904	セラファインS M A3	M	
BCDM17905	セラファインS M A3.5		
BCDM17906	セラファインH 14M A2		
BCDM17907	セラファインH 14M A3	14M	
BCDM17908	セラファインH 14M A3.5		

販売名:セラファインS/分類:管理医療機器/一般の名称:歯科切削加工用レジン材料/医療機器認証番号:302AFBZX00052A01
販売名:セラファインH/分類:管理医療機器/一般の名称:歯科切削加工用レジン材料/医療機器認証番号:302AFBZX00037A02

発売元

京セラメディカル株式会社
<https://www.kyocera-medical.co.jp>

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

札幌営業所	札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001	Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525
東京営業所	東京都港区三田3丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073	Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560
名古屋営業所	名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002 (注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。	Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
大阪営業所	大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003	Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157
岡山営業所	岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826	Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289
九州営業所	福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013	Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

製造販売元 株式会社 カム・ネット 〒578-0903 東大阪市今米1-17-12 TEL.072-966-4180 FAX.072-963-4182

本資料に記載の情報は2025年10月時点のものです。
本資料については、無断で複製、転載することを禁じます。
「CeraFine」(ロゴ)は京セラメディカル株式会社の登録商標です。
© 2025 KYOCERA Medical Corporation
2_075 [D-150-4w]