



Ver.2.2

BIOCERAM AZUL[®]



History of "BIOCERAM[®]"


BIOCERAM[®] AL190

BIOCERAM[®] ZR195


BIOCERAM[®] AZ209

BIOCERAM AZUL[®]


Material and Strength

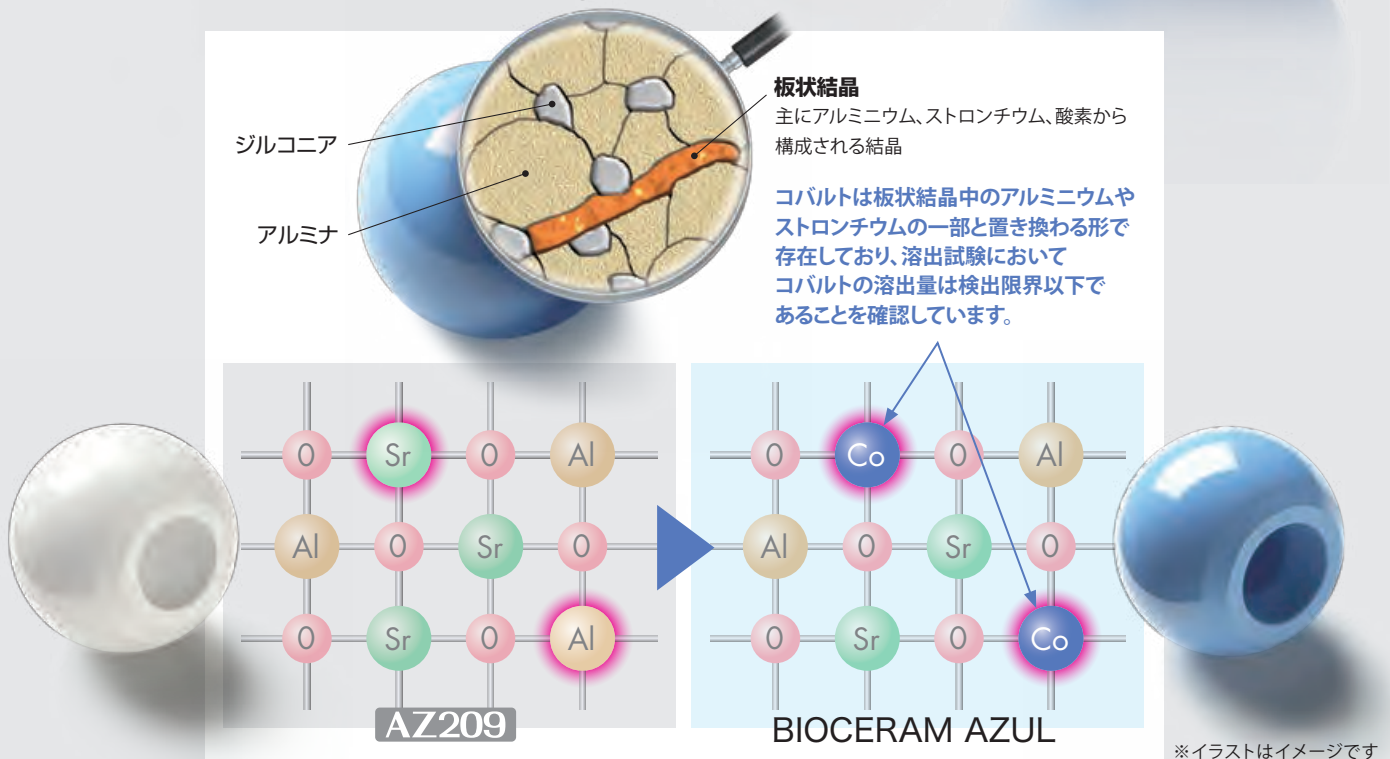

©2015 KYOCERA Corporation

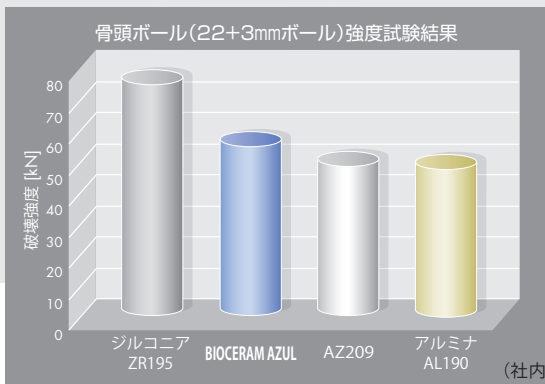


BIOCERAM AZULの強度はアルミナとジルコニアの中間に位置します。

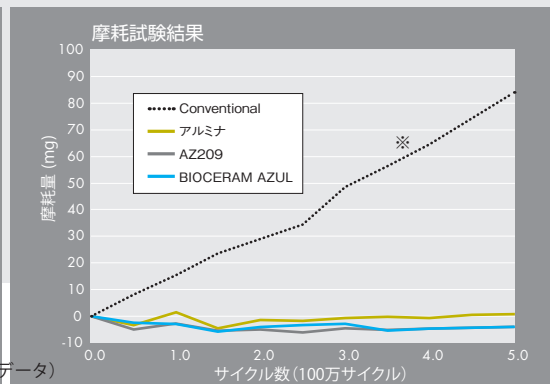

BIOCERAM AZULの摩耗特性はアルミナやAZ209と同等です。

※メタル骨頭ボールとコンベンショナルポリエチレン



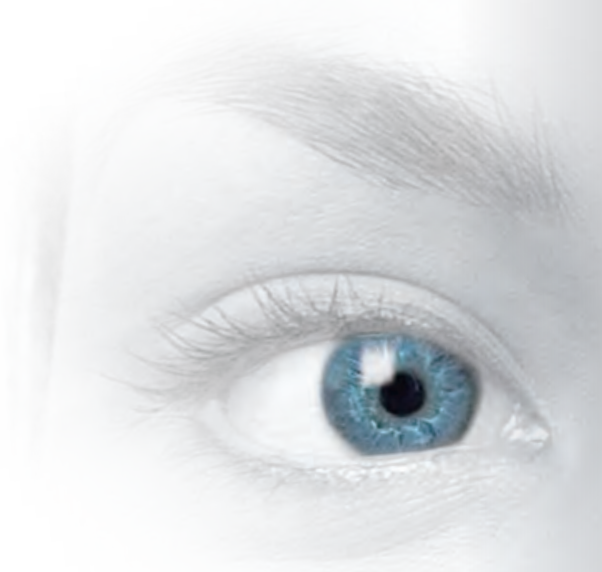

Aquala Combination



SQRUM TT

- 一体型積層成形による3Dポーラス
強固なスクラッチによる初期固定が得られます。

Aquala

- 生体軟骨を模倣した、表面処理

BIOCERAM AZUL®

- ZTA (ジルコニア強化アルミナ) セラミック

※写真はイメージです。

BIOCERAM (ロゴ)、BIOCERAM AZUL、Aquala (ロゴ) 及び SQRUMは、京セラメディカル株式会社の登録商標です。

販売名：SQRUM TTシェル 医療機器承認番号：22500BZX00323000 一般的名称：人工股関節寛骨臼コンポーネント 高度管理医療機器（クラスⅢ）
販売名：Aquala ライナー 医療機器承認番号：22300BZX00234000 一般的名称：人工股関節寛骨臼コンポーネント 高度管理医療機器（クラスⅢ）

製造販売元：京セラメディカル株式会社

BIOCERAM AZUL[®]



■ 12/14 BIOCERAM AZULボール

骨頭径	商品No.	商品名	ネック長
φ26mm	AMH04-400053	1214AZULボール26:+0 ※	+0mm
	AMH04-400054	1214AZULボール26:+3.5 ※	+3.5mm
φ28mm	AMH04-400056	1214AZULボール28:-3.5	-3.5mm
	AMH04-400057	1214AZULボール28:+0	+0mm
	AMH04-400058	1214AZULボール28:+3.5	+3.5mm
φ32mm	AMH04-400061	1214AZULボール32:-3.5	-3.5mm
	AMH04-400062	1214AZULボール32:+0	+0mm
	AMH04-400063	1214AZULボール32:+3.5	+3.5mm
	AMH04-400064	1214AZULボール32:+7 ★	+7mm
φ36mm	AMH04-400065	1214AZULボール36:-3.5	-3.5mm
	AMH04-400066	1214AZULボール36:+0	+0mm
	AMH04-400067	1214AZULボール36:+3.5	+3.5mm
	AMH04-400068	1214AZULボール36:+7 ★	+7mm
φ40mm	AMH04-400071	1214AZULボール40:-3.5	-3.5mm
	AMH04-400072	1214AZULボール40:+0	+0mm
	AMH04-400073	1214AZULボール40:+3.5	+3.5mm
	AMH04-400074	1214AZULボール40:+7 ★	+7mm

■ 910 BIOCERAM AZULボール

骨頭径	商品No.	商品名	ネック長
φ22mm	CMT21002	910 AZULボール 22:+0	+0mm
	CMT21003	910 AZULボール 22:+3	+3mm
φ26mm	CMT21012	910 AZULボール 26:+0	+0mm
	CMT21013	910 AZULボール 26:+3	+3mm
	CMT21014	910 AZULボール 26:+6	+6mm
φ28mm	CMT21022	910 AZULボール 28:+0	+0mm
	CMT21023	910 AZULボール 28:+3	+3mm
	CMT21024	910 AZULボール 28:+6	+6mm
φ32mm	CMT21032	910 AZULボール 32:+0	+0mm
	CMT21033	910 AZULボール 32:+3	+3mm
	CMT21034	910 AZULボール 32:+6	+6mm
	CMT21036	910 AZULボール 32:+9	+9mm
φ36mm	CMT21042	910 AZULボール 36:+0	+0mm
	CMT21043	910 AZULボール 36:+3	+3mm
	CMT21044	910 AZULボール 36:+6	+6mm
	CMT21046	910 AZULボール 36:+9	+9mm

※、★はINHERITORのみ組み合わせ可能です。CHANGEA、Mainstayは組み合わせできません。
★はあらかじめ在庫に関するお問合せをお願いします。

材質はジルコニア強化アルミナ・セラミックスです。

販売名：BIOCERAM AZULヘッド 医療機器承認番号：22600BZX00510000 一般的名称：人工股関節大腿骨コンポーネント 高度管理医療機器（クラスⅢ）

製造販売元：京セラメディカル株式会社

組み合わせ可能な12/14 STEM



CHANGEA



Mainstay



INHERITOR

販売名：CHANGEA HIPシステム
販売名：Mainstayシステム
販売名：MainstayネックV30
販売名：INHERITOR システム

医療機器承認番号：22500BZX00201000
医療機器承認番号：22700BZX00041000
医療機器承認番号：22700BZX00042000
医療機器承認番号：22800BZX00161000

一般的名称：人工股関節大腿骨コンポーネント 高度管理医療機器（クラスⅢ）
一般的名称：人工股関節大腿骨コンポーネント 高度管理医療機器（クラスⅢ）
一般的名称：人工股関節大腿骨コンポーネント 高度管理医療機器（クラスⅢ）
一般的名称：人工股関節大腿骨コンポーネント 高度管理医療機器（クラスⅢ）

製造販売元：京セラメディカル株式会社



京セラメディカル株式会社

<https://www.kyocera-medical.co.jp>

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450

CHANGEA、Mainstay\メインステイ、INHERITORは、京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当パンフレットに記載の情報は2025年10月時点のものです。
当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。

© 2025 KYOCERA Medical Corporation

5_008 [M-086-5t]